


Área: Temperatura

Fecha de elaboración:	2024-05	No. Registro:	NP-TTG24-02
Elaborado por:	Arturo A. Díaz	Vigencia hasta:	2024-11

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)
 CNM-PNE-02
 Puntos fijos

H ₂ O	U = 2 x 10 ⁻³ K	Sn	U = 3 x 10 ⁻⁴ K
Ar	U = 3 x 10 ⁻⁴ K	Zn	U = 4 x 10 ⁻⁴ K
Hg	U = 1 x 10 ⁻⁴ K	Al	U = 5 x 10 ⁻⁴ K
Ga	U = 2 x 10 ⁻⁵ K	Ag	U = 1 x 10 ⁻³ K
In	U = 2 x 10 ⁻⁵ K		

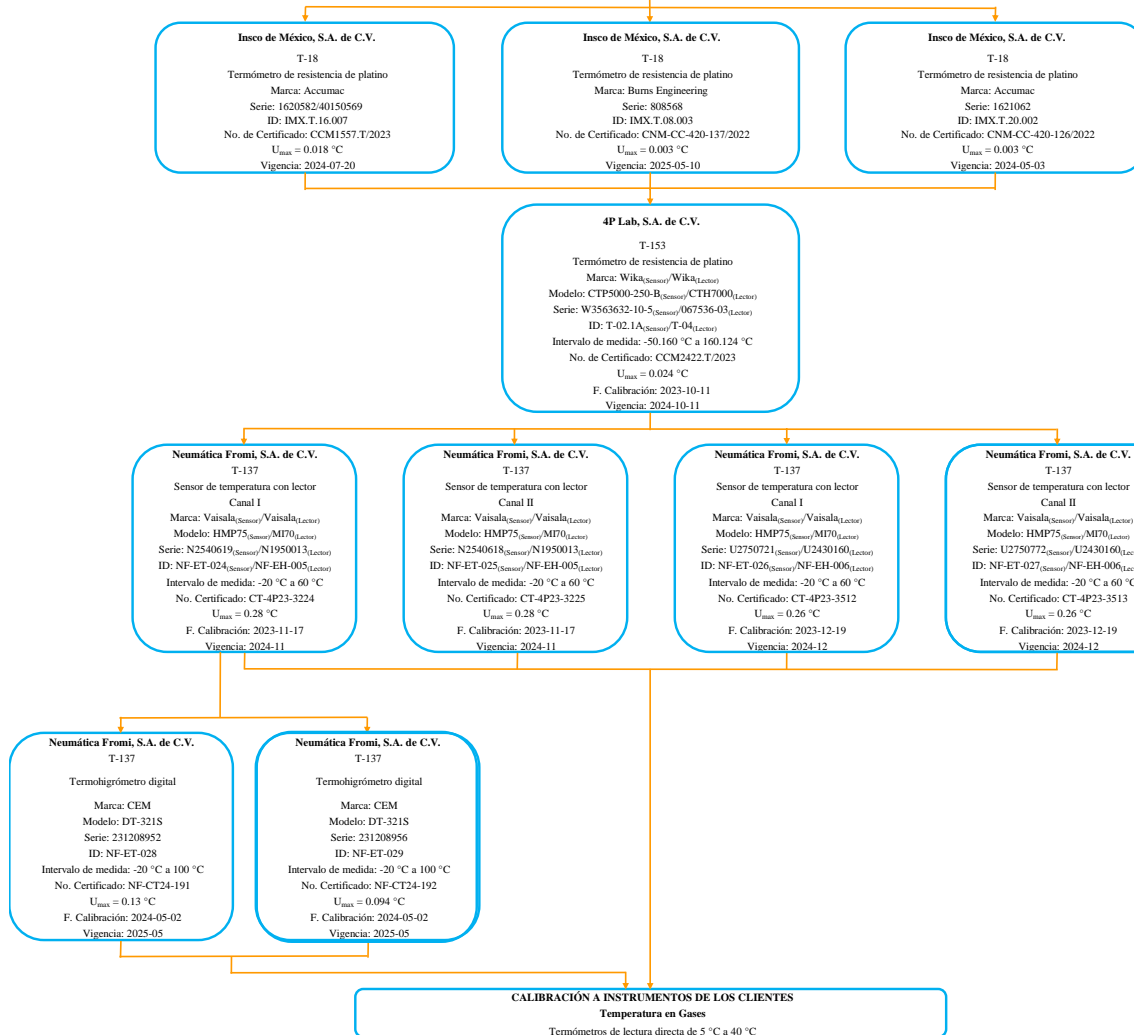

CALIBRACIÓN A INSTRUMENTOS DE LOS CLIENTES
 Temperatura en Gas
 Termómetros de lectura directa de 5 °C a 40 °C

